



A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 820/2023

Disputa: 23/11/2023

MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES – MA HOSPITALAR com filial estabelecida à Rua Brigadeiro Franco, 3636 – Curitiba– PR, inscrita sob C.N.P.J. n.º 04.078.043/0003-02, por seu procurador infra-assinado, com fundamento na Lei Federal n.º 14.133-21, vem, respeitosamente, e tempestivamente **APRESENTAR RECURSO ADMINISTRATIVO**;

I. DOS FATOS E DAS FUNDAMENTAÇÕES.

A empresa Monteiro Antunes participou do Pregão Eletrônico 820/2023, e vem solicitar a desclassificação das empresas abaixo, por não atender ao edital no que diz:

Item 02: Foco Cirúrgico de Teto Duplo

Empresa: NEXT MEDICAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Marca/Fabricante INPROMED DO BRASILTEM


Modelo/Versao: FOCO DUPLO MODELO INP 5X5F MASTER COM 320.000 LUX

Edital solicita “quantidade mínima de 85 (oitenta e cinco) LEDs na sua composição”, no entanto segundo o manual, o item apresenta “contendo ao todo de 5 a 105 LEDs por cúpula”, não especificando a quantidade.

Nos focos SL-300 a iluminação é feita através de um módulo de LEDs de alto rendimento com lentes de convergência, e nos focos INP-MASTER com 3, 4 ou 5 módulos de LEDs, de alto rendimento com lentes de convergência, contendo ao todo de 5 a 105 LEDs por cúpula, todos protegidos por umacapa em material polimérico transparente. Sua temperatura de cor pode variar, nos equipamentos que possibilitam esse ajuste, permitindo a melhor diferenciação da coloração dos tecidos feita pelo cirurgião.

O Edital Solicita “O foco cirúrgico deverá possuir os seus comandos individuais por cúpula, em LCD com membrana em policarbonato de fácil higienização, garantindo assim maior resistência ao produto. Sendo eles: Liga/Desliga, Modo Endo, Ajuste de Temperatura de Cor e Dimmer (controle da intensidade luminosa

com pelo menos 8 graduações). O Dimmer (controle da intensidade luminosa com pelo menos 8 graduações)” no manual, não especifica o número de graduações, apenas relata que são ajustadas para mais ou menos.



(*) DIMMER: O dimmer permite variar a intensidade da luz entre um máximo e um mínimo utilizando os botões (+) e (-). A intensidade de luz é indicada pelos LEDs adjacentes aos botões.

Também é possível realizar a dimerização nos equipamentos, quando os mesmos estão com o Sistema de Emergência acionado.

(**) ENDO: Ao acionar o Módulo ENDO liga-se uma luz baixa (penumbra) localizada acima do manete a qual se utiliza para cirurgia não evasiva (cirurgia por vídeo).

Item 03: Cama ELÉTRICA HOSPITALAR

Empresa: MOVEIS ANDRADE – INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA

Marca/Fabricante: MOVEIS ANDRADE INDUS COM DE MOVEIS HOSP. LTDA

Modelo/Versao: MA 489 B 250/2023

No edital pede-se:

Deve possuir bateria de lítio ou níquel hidreto metálico recarregável

Manual do Moveis Andrade consta (pág. 44):

O motivo pelo qual o edital pede a bateria de lítio faz sentido pois oferecem numerosas vantagens: têm uma maior densidade energética, maior eficiência e um ciclo de vida mais longo. As baterias de chumbo ácido permitem 1.500 ciclos de vida, enquanto a tecnologia das baterias de lítio oferece até 2.500 ciclos de vida.

Bateria	
Tensão de Saída	24 Vdc, 1,3 Ah/ 24 Vcc
Tensão de Entrada	24 Vdc a 40 Vdc ou 29 W
Tempo em Operação	Até 18 hrs contínuo com 100% de carga sem recarregar
Grau Proteção (A variação do Grau de proteção IP se dará de acordo com o pedido do cliente)	IPX6 (padrão) - O equipamento é resistente a jatos de água (com opção de IP66 (opcional) – O equipamento é resistente a jatos potentes de poeira e à jatos potentes de água).
Composição Química	Selada de Chumbo/ Ácido chumbo selada
Material Externo	ABS
Cabo de Alimentação	1000 mm
Ciclo de Operação	10%, 2min ON / 18min OFF
Temperatura de Trabalho	0 a 45°C

O motivo pelo qual o edital pede a bateria de lítio faz sentido pois oferecem numerosas vantagens: têm uma maior densidade energética, maior eficiência e um ciclo de vida mais longo. As baterias de chumbo ácido permitem 1.500 ciclos de vida, enquanto a tecnologia das baterias de lítio oferece até 2.500 ciclos de vida.

Ainda no edital pede-se sobre a bateria:

IPX4. Alimentação elétrica: Bivolt Automático, cabo de alimentação padrão ABNT. **Bateria interna com autonomia de pelo menos 100 movimentos**, com sistema de comutação automática em caso de queda de

No manual do Moveis Andrade consta (pág. 45):

Observações importantes – Bateria:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ao desconectar a cama motorizada da rede elétrica, a bateria possibilitará aproximadamente 80 acionamentos, respeitado o uso intermitente dos atuadores.

No edital pede-se:

Protetores contra impacto nos quatro cantos do leito; **Ganchos laterais para colocação de bolsas e dispositivos urinários em ambos os lados**; Elevação do encosto com sistema que diminui a pressão sobre o

No manual do moveis Andrade consta (pág. 68):

- **Ganchos de fixação de dreno sob o leito;**

No edital pede-se:

ACESSÓRIOS*:

01 (um) colchão compatível com a capacidade e dimensões da cama, com no mínimo 12 cm de espessura densidade 28 ou superior, revestido por material impermeável isento de qualquer tipo de látex em sua composição **não ultrapassando 10kg** e cobertura retardante de fogo, com dimensões compatíveis com o

Não encontramos no manual do Moveis Andrade essa informação de quanto pesa o colchão oferecido.

Item 11: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

Empresa: VALMIL HOSPITALAR LTDA

Marca/Fabricante: NIHON KOHDEN

Modelo/Versao: BSM-3763


Edital solicita: “Capaz de realizar aquisição de ECG de 12 derivações e imprimir o exame.”

O item apresentado imprime via conexão a impressora da rede, conforme descrito no manual “Envio de dados à impressora da rede; muitos comandos de impressão enviados à impressora da rede.”

impressora da rede.

Print (Impressão) Configurações de impressora incorretas. Configure corretamente a impressora na janela PRINTER da tela SYSTEM CONFIGURATION.

Edital solicita: “Capacidade de comunicação com outros dispositivos médicos, monitores hemodinâmicos, ventiladores etc”.

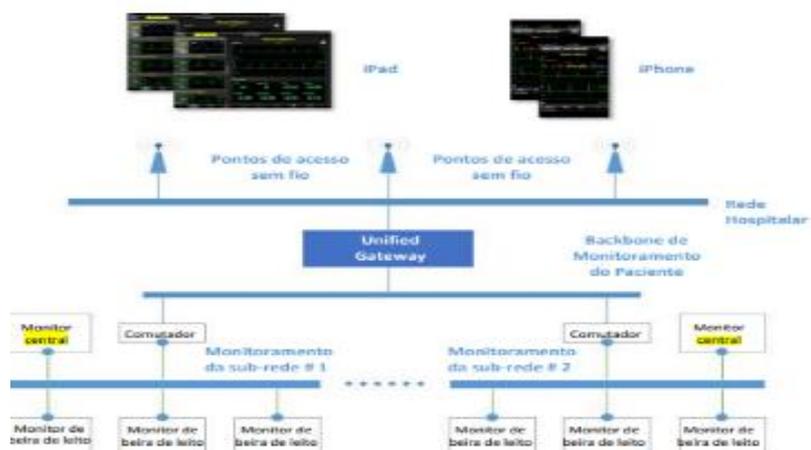

O item apresenta conexão com somente central de monitores, não fala nada sobre conexão com ventiladores no manual.

O edital solicita: “Possibilidade de expansão para uso simultâneo de até 07 pressões invasivas.”



O item possui apenas 02 pressões invasivas.

Parâmetros de medição

ECG, respiração pelo método de impedância, SpO₂, **PANI**, IBP (BSM-3532/3552/3562/3572: máximo de 2 canais; BSM-3733/3753/3763/3773: máximo de 3 canais), temperatura, débito cardíaco, CO₂ pelos métodos de vazão principal e lateral, vazão/Paw, BIS, gás anestésico (CO₂, O₂, N₂O, agente), TOF, ventilação, CCO, EEG, tcPO₂, tcPCO₂, rSO₂.

O edital solicita: “Impedância do sensor. Transmissão Neuromuscular – TNM. Estimulação: Controle de estímulo do módulo TNM com teclas no dispositivo e em teclas virtuais no monitor”.

O item apresentado não apresenta TNF.

II. DO PEDIDO.

Logo, a recorrente **PEDE O ACOLHIMENTO** deste como **RECURSO**, e requer seja reconsiderada a decisão de Vossa Senhoria, estabelecendo seu julgamento dentro das leis editalícias e princípios que a regem, declarando desta forma **DECLASSIFICADA** as empresas **NEXT MEDICAL, MOVEIS ANDRADE, VALMIL HOSPITALAR LTDA** e na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este subir, devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade a Lei n° 14.133-21.

Termos em que,

Pede Deferimento.

Curitiba, 07 de dezembro 2023.

Michele Ramos – Representante legal

MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES.



04.078.043/0003-02
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS
HOSPITALARES I
RUA BRIGADEIRO FRANCO, 3636
REBOUÇAS - CEP 80220-100
CURITIBA - PR